

BIO.CASH Version	Datum	Seite
2.0.28	09.01.2021	1 von 12

Sehr geehrte Anwender,

anbei erhalten Sie eine Update-Information zur neuen BIO.CASH Version 2.0.28.



---

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b><u>1</u></b>	<b><u>TSE - SICHERUNGSEINRICHTUNG.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>DSFINV-K.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>HINWEIS DATENSICHERUNG .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>SONSTIGE ÄNDERUNGEN MIT BIO.CASH 2.0.28 .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>4.1</b>	<b>AUTOMATISCHER TIMEOUT.....</b>	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>BON-TRANSFER MIT POSITIONEN .....</b>	<b>5</b>
<b>4.3</b>	<b>GEÄNDERTER MAIL-VERSAND .....</b>	<b>5</b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>UPDATE VON BIO.CASH .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b>5.1</b>	<b>WENN SIE EINE VERSION VOR BIO.CASH 2.0.28 EINSETZEN .....</b>	<b>7</b>
5.1.1	AUF NEUES UPDATE PRÜFEN .....	7
5.1.2	NEUE VERSION ÜBERTRAGEN.....	8
5.1.3	NEUE VERSION ZUR INSTALLATION VERTEILEN .....	9
<b>5.2</b>	<b>WENN SIE BEREITS DIE VERSION 2.0.28 EINSETZEN.....</b>	<b>10</b>
5.2.1	AUF NEUES PATCH PRÜFEN .....	10
5.2.2	NEUES PATCH ÜBERTRAGEN .....	11
5.2.3	NEUE VERSION ZUR INSTALLATION VERTEILEN .....	12

## 1 TSE – Technische Sicherheitseinrichtung

Zur Einrichtung der TSE erhalten Sie eine gesonderte Anleitung.

Voraussetzung zur Inbetriebnahme der TSE ist das vorherige Update auf BIO.CASH 2.0.28.

Die Vorgehensweise zum Online-Update finden Sie in Kapitel 5 ab Seite 6 in diesem Dokument.

Die Version 2.0.28 ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme einer TSE, deswegen sollten Sie ihre Version zeitnah aktualisieren.


Die Inbetriebnahme der TSE muss nicht zeitgleich erfolgen.

## 2 DSFinV-K

Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung ("Z3-Zugriff") im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschaun.

DSFinV-K ist eine Abkürzung für „Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme“

Der neue DSFinV-K Export und der bisherige GdPdU-Export sind unter Abrechnungen – Exporte zu finden.

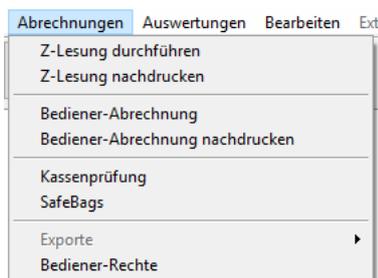

Dieser Programmbereich muss ggf. freigeschalten werden. Dies kann über den Support geschehen.

Der Export wird mit Angabe des zu exportierenden Zeitraums gestartet.



Nach erfolgreichem Export befinden sich mehrere Dateien im Ordner „export\DFSinV-K“




### 3 Hinweis Datensicherung

Alle Daten der Kasse sind in Deutschland für mindestens 10 Jahre aufbewahrungspflichtig.

**Bitte sorgen Sie für eine regelmäßige Datensicherung des kompletten BIO.CASH BackOffice Verzeichnis (z.B. c:\dennree\bicash) incl. aller Unterverzeichnisse auf ein externes Medium.**

**Bei Nutzung eines SQL-Servers müssen auch die Datenbanken gesichert werden.**

Als Hinweis auf eine notwendige Sicherung erhalten Sie in regelmäßigen Abständen nach dem Login folgenden Hinweis im BackOffice.

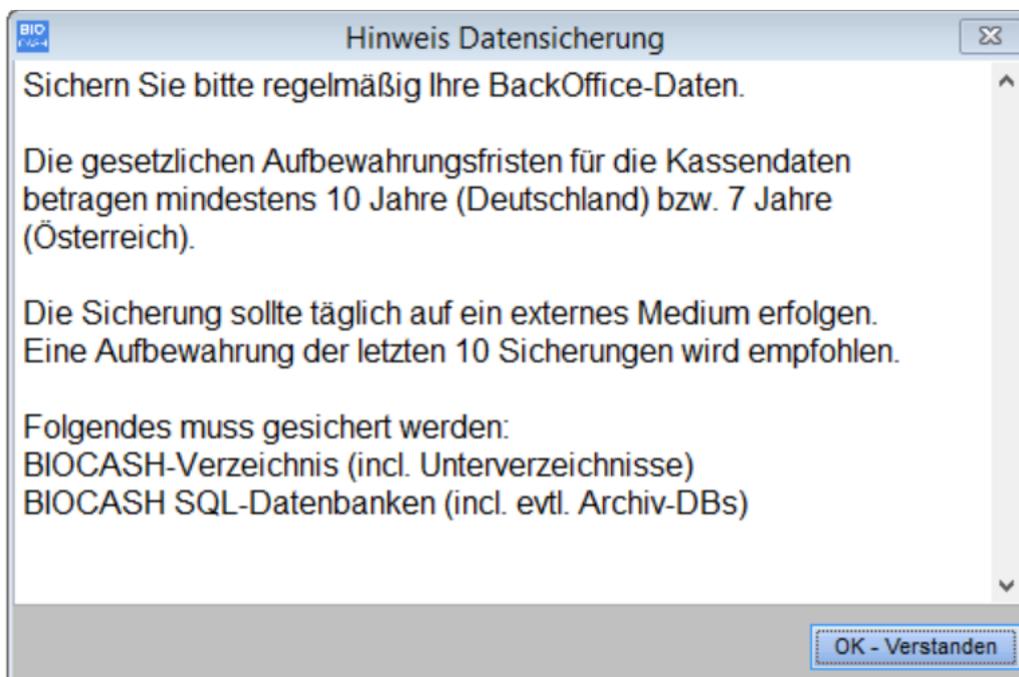

Bei Vorliegen einer entsprechenden Erklärung über eine regelmäßige Datensicherung kann dieser Hinweis deaktiviert werden.

## 4 Sonstige Änderungen mit BIO.CASH 2.0.28

### 4.1 Automatischer Timeout

Sollte keine automatische Abmeldung der Kasse bei Inaktivität definiert sein, so wird die Kasse ab BIO.CASH 2.0.28 nach 60min Inaktivität abgemeldet.

### 4.2 Bon-Transfer mit Positionen


Der Ausdruck des Bon-Transferbeleg enthält nun auch die Positionen des Transfer-Bons.

### 4.3 Geänderter Mail-Versand


Das Versenden von Emails aus BIO.CASH heraus wurde technisch neu gestaltet.

## 5 Update von BIO.CASH

Das Online-Update starten Sie im Menü „Extras – Online-Update“:

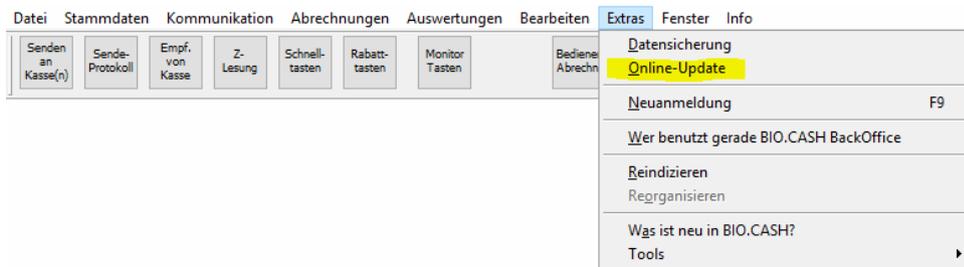


Folgendes Fenster öffnet sich:

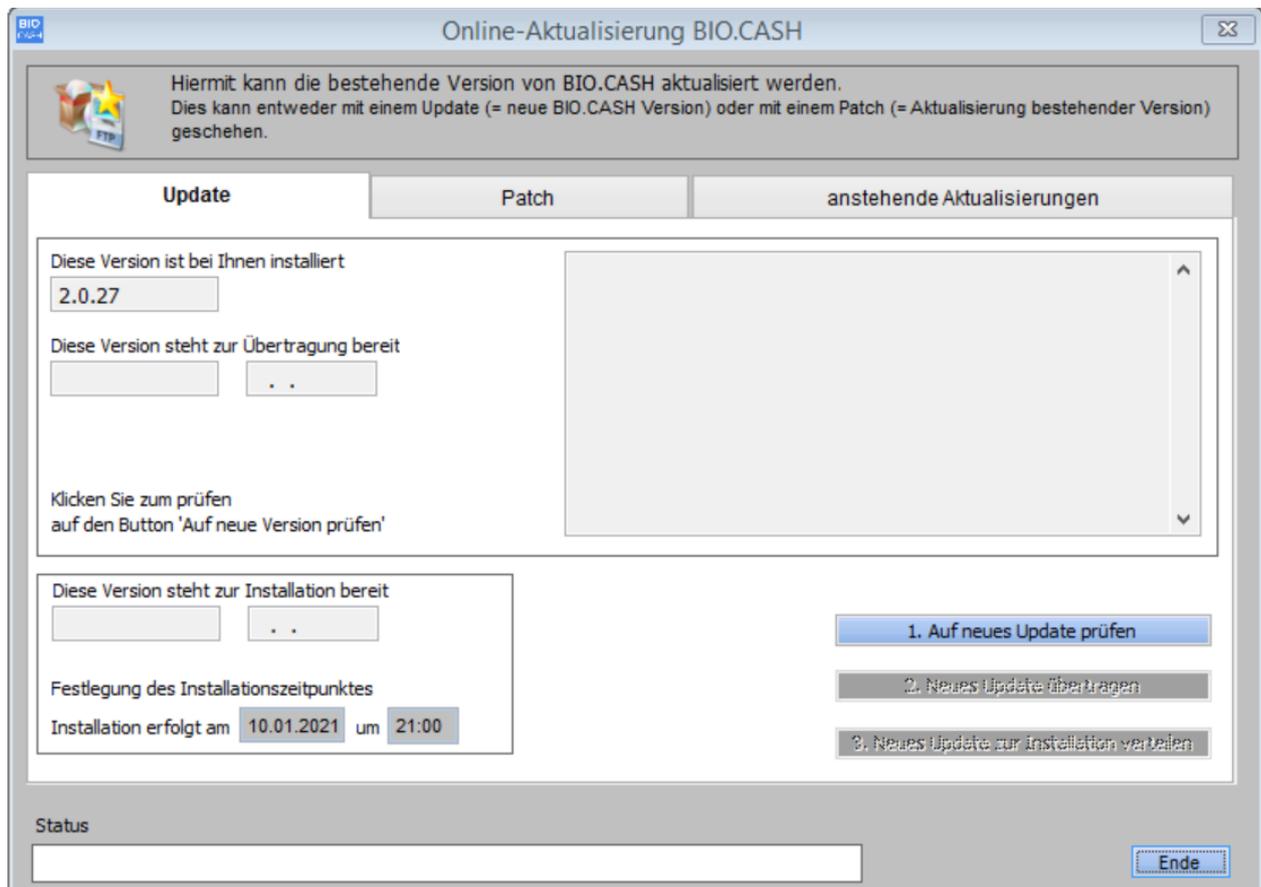

BIO.CASH Version	Datum	Seite
2.0.28	09.01.2021	7 von 12


## 5.1 Wenn Sie eine Version vor BIO.CASH 2.0.28 einsetzen

Im Bereich Updates wird eine ältere Version von BIO.CASH (z.B. 2.0.27) aktualisiert:

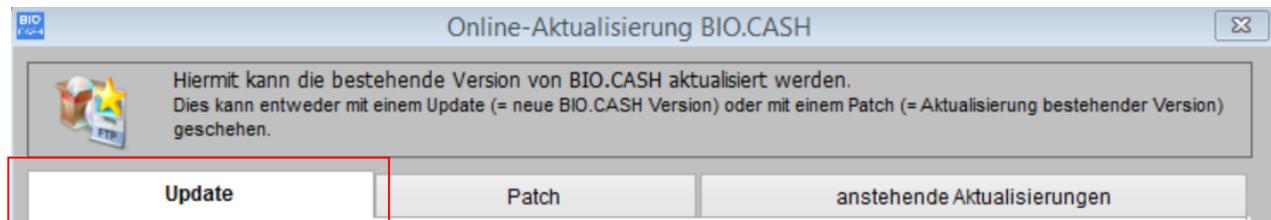


### 5.1.1 Auf neues Update prüfen

Klicken Sie in der Online-Aktualisierung auf den Punkt „1. Auf neues Update prüfen“




Nach der Prüfung werden Informationen zur neuen Version angezeigt:

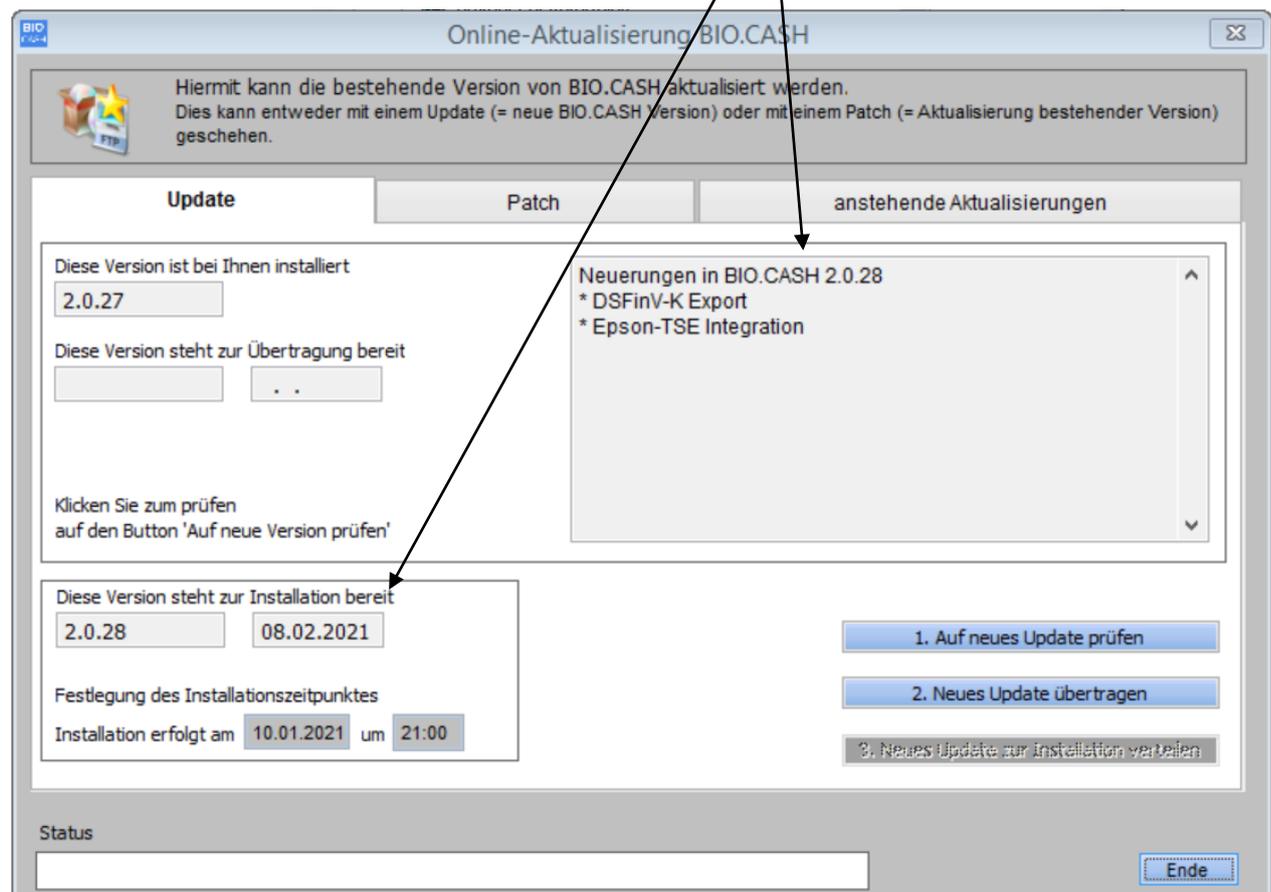

Falls ein Update verfügbar ist wird der Button „2. Neue Version übertragen“ aktiv.

## 5.1.2 Neue Version übertragen

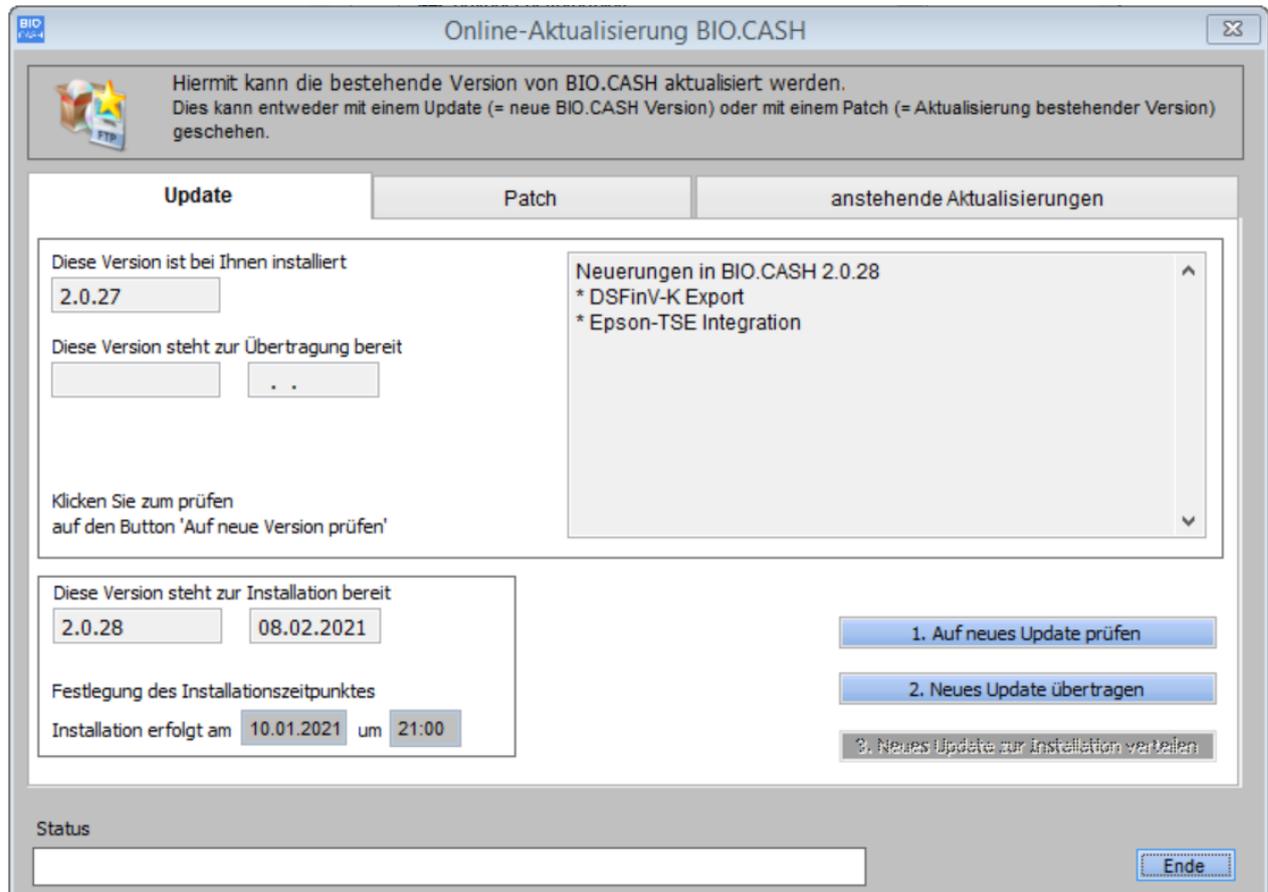


Wenn eine neue Version zum Download bereitsteht wird der Button



aktiv.

Sollte trotz einer neuen Version der Button „2. Neue Version übertragen“ nicht aktiv werden,




dann beenden Sie bitte das Online-Update und starten Sie es erneut.

Mit einem Klick auf den Button „2. neues Update übertragen“ wird die neue Version übertragen:




### 5.1.3 Neue Version zur Installation verteilen

Nach erfolgreicher Übertragung der neuen Version wird der Button „3. neue Version zur Installation verteilen“ aktiv.

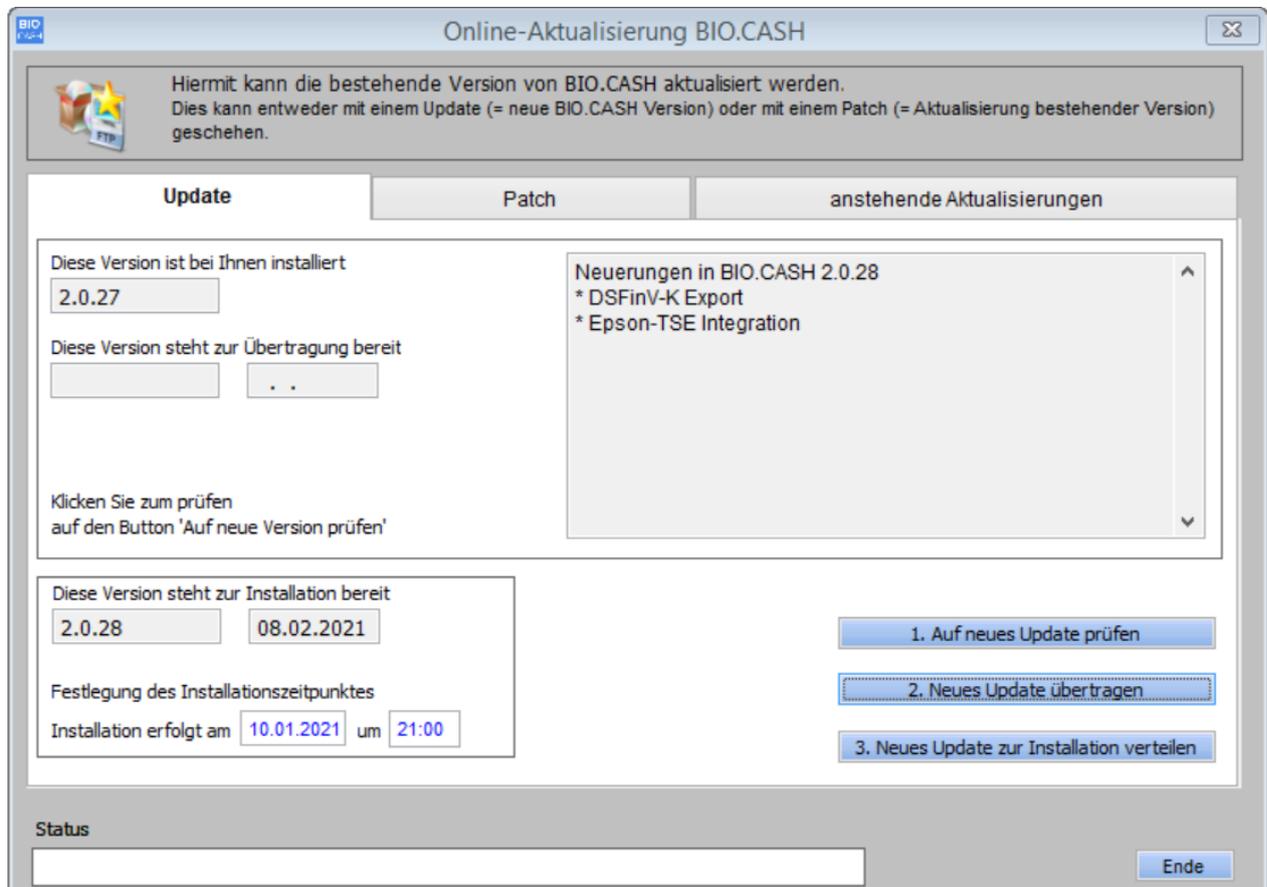

Der Zeitpunkt der Installation wird hier festgelegt:




Bei einem Installationszeitpunkt in der Zukunft wird das Update zum angegebenen Zeitpunkt durchgeführt, liegt der Zeitpunkt in der Vergangenheit erfolgt das Update sofort.

Wir empfehlen eine Installation außerhalb der Öffnungszeiten, da diese einige Minuten in Anspruch nimmt und die Kasse in dieser Zeit nicht benutzt werden kann.

An den Kassen muss der Bediener abgemeldet sein, die Kassenanwendung darf nicht beendet sein.

Mit einem Klick auf den Button




wird das Patch zur Installation verteilt.

BIO.CASH Version	Datum	Seite
2.0.28	09.01.2021	10 von 12


## 5.2 Wenn Sie bereits die Version 2.0.28 einsetzen

Wenn Sie bereits die Version 2.0.28 im Einsatz haben können Sie ggf. die Version aktualisieren.

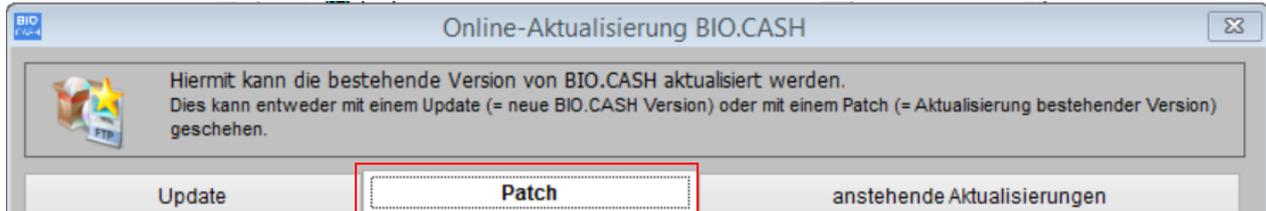


### 5.2.1 Auf neues Patch prüfen


Klicken Sie in der Online-Aktualisierung auf den Punkt „1. Auf neues Patch prüfen“



Nach der Prüfung werden Informationen zur neuen Version angezeigt:

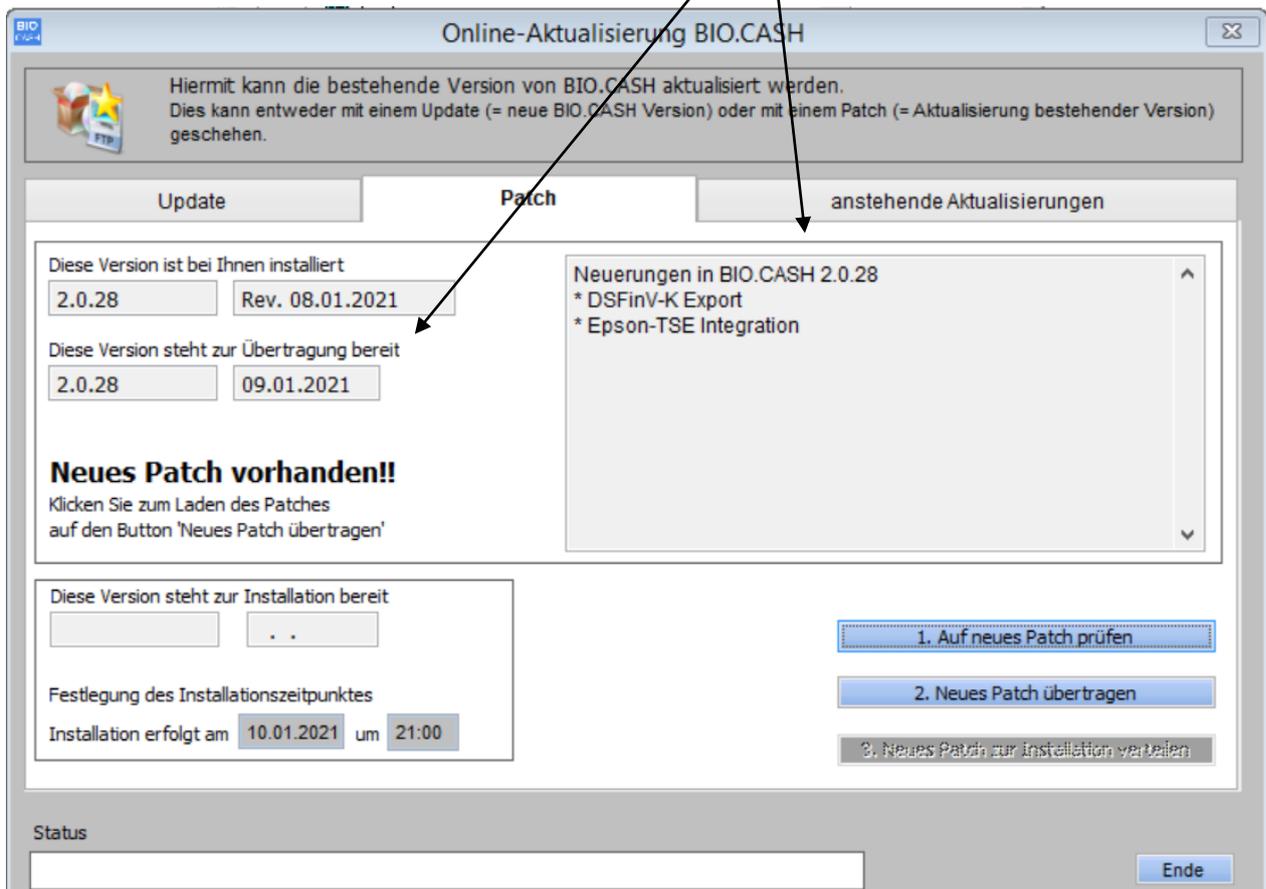

## 5.2.2 Neues Patch übertragen

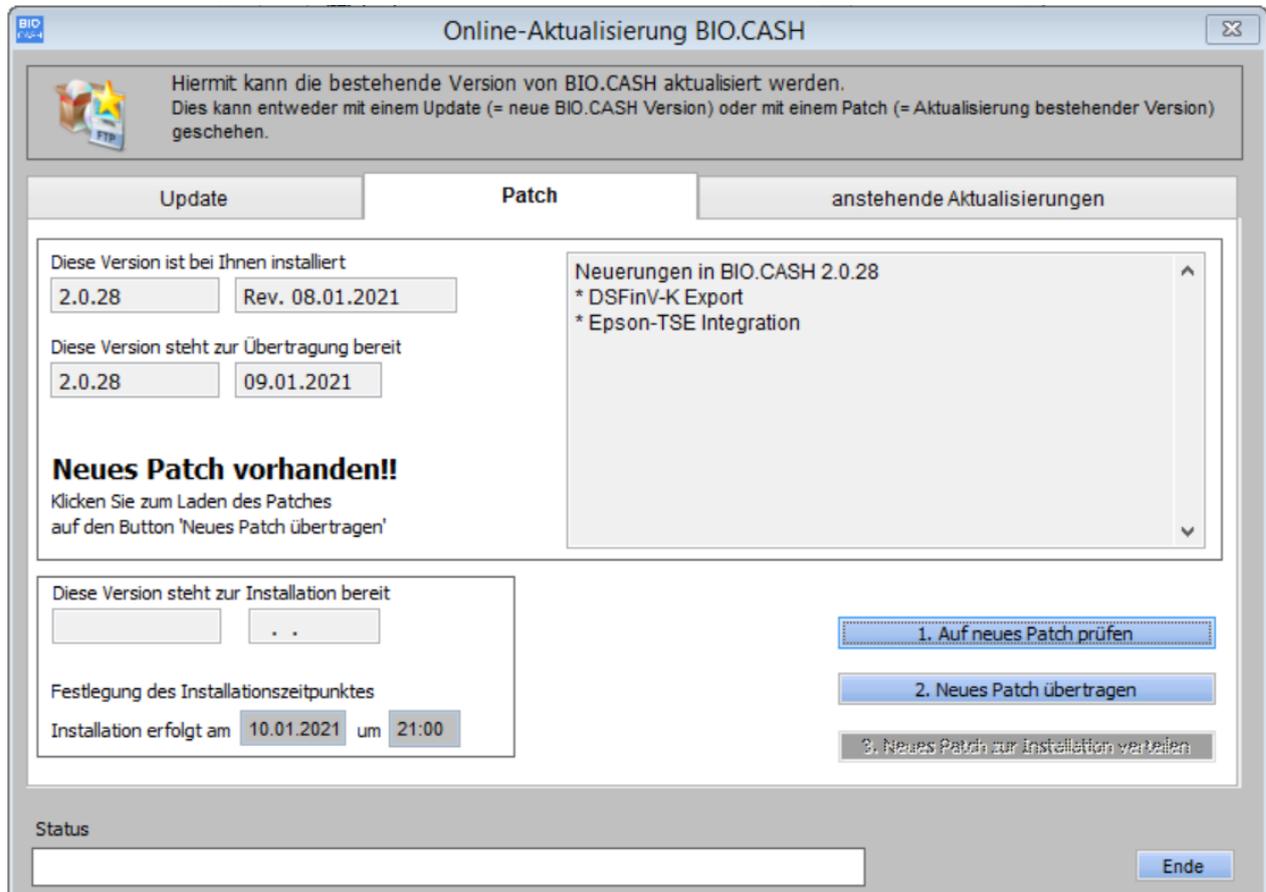

Wenn eine neues Patch zum Download bereitsteht wird der Button




aktiv.

Mit einem Klick auf den Button „2. Neues Patch übertragen“ wird das neue Patch übertragen:



### 5.2.3 Neue Version zur Installation verteilen

Nach erfolgter Übertragung der neuen Version wird der Button „3. neue Version zur Installation verteilen“ aktiv.

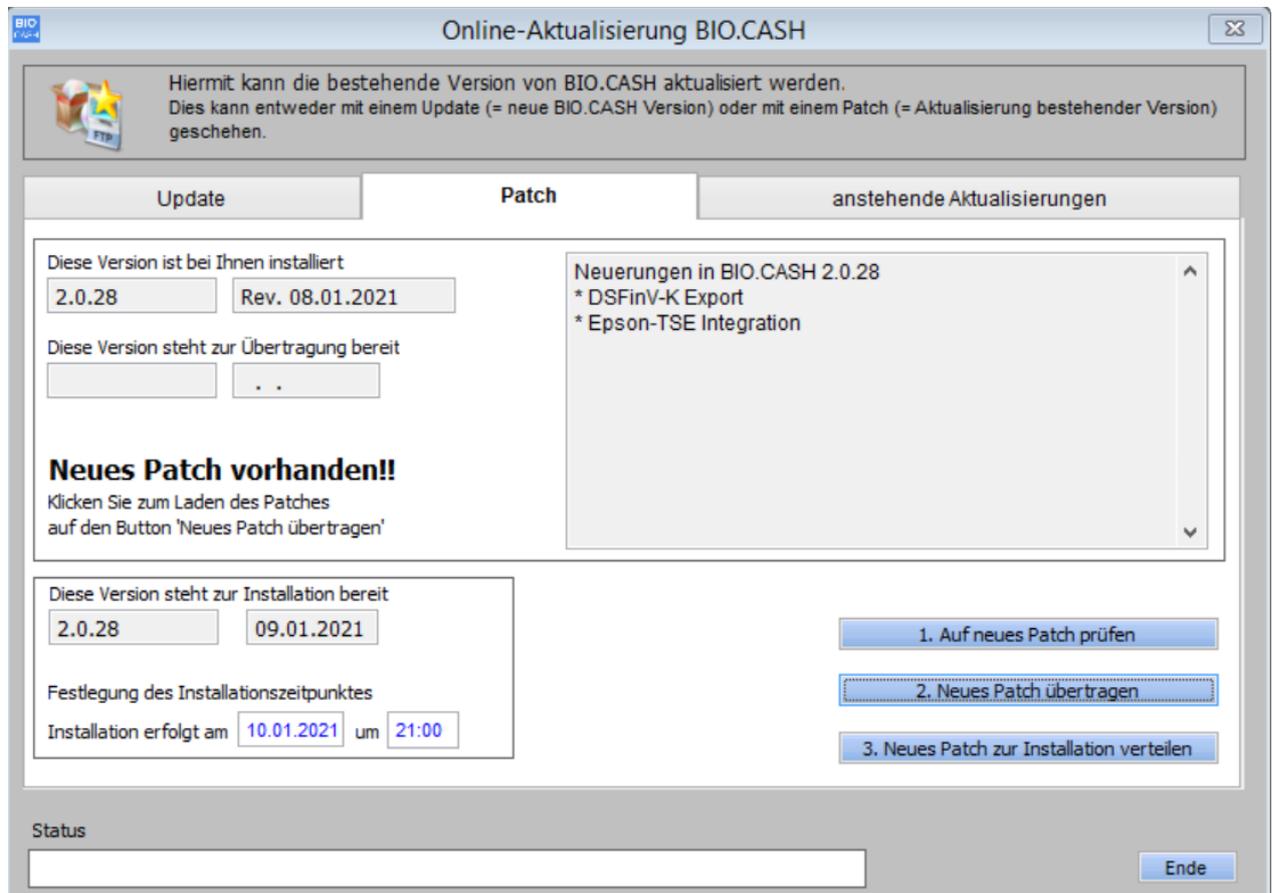

Hiermit kann die bestehende Version von BIO.CASH aktualisiert werden.  
Dies kann entweder mit einem Update (= neue BIO.CASH Version) oder mit einem Patch (= Aktualisierung bestehender Version) geschehen.

Update Patch anstehende Aktualisierungen

Diese Version ist bei Ihnen installiert  
2.0.28 Rev. 08.01.2021

Diese Version steht zur Übertragung bereit

**Neues Patch vorhanden!!**  
Klicken Sie zum Laden des Patches auf den Button 'Neues Patch übertragen'

Neuerungen in BIO.CASH 2.0.28  
\* DSFinV-K Export  
\* Epson-TSE Integration

Diese Version steht zur Installation bereit  
2.0.28 09.01.2021

Festlegung des Installationszeitpunktes  
Installation erfolgt am 10.01.2021 um 21:00

1. Auf neues Patch prüfen  
2. Neues Patch übertragen  
3. Neues Patch zur Installation verteilen

Status

Ende

Der Zeitpunkt der Installation wird hier festgelegt:

Festlegung des Installationszeitpunktes  
Installation erfolgt am 10.01.2021 um 21:00

Bei einem Installtionszeitpunkt in der Zukunft wird das Patch zum angegebenen Zeitpunkt durchgeführt, liegt der Zeitpunkt in der Vergangenheit erfolgt das Patch sofort.

Die Installation eines Patches dauert ca. 60 Sekunden, dies kann auch während des Verkaufstages erfolgen.

An den Kassen muss der Bediener abgemeldet sein, die Kassenanwendung darf nicht beendet sein.

Mit einem Klick auf den Button

3. Neues Patch zur Installation verteilen

wird das Patch zur Installation verteilt.